


PATIENTSÄKERHET

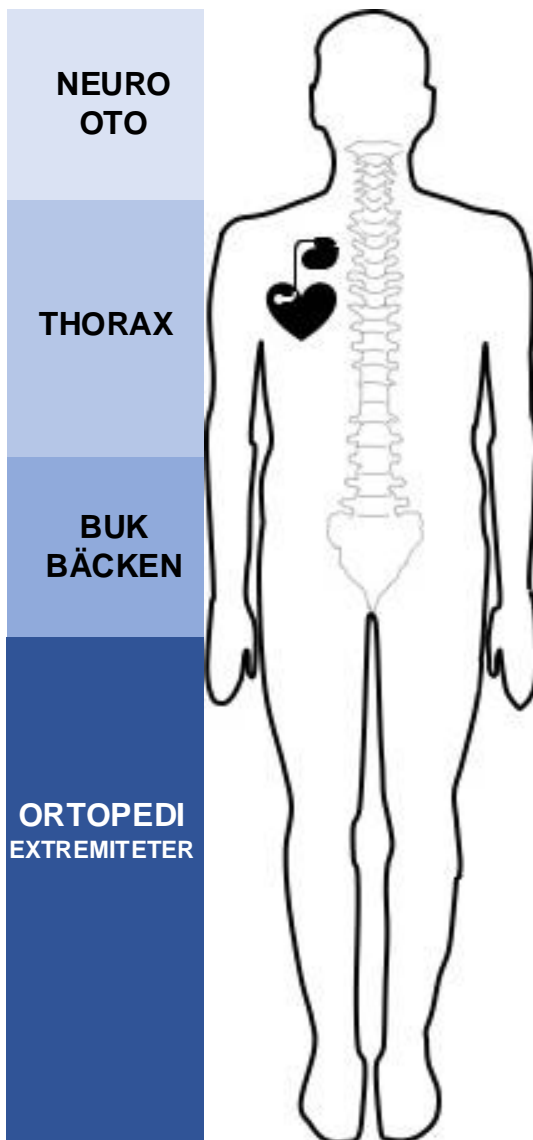


ÖVRIGA IMPLANTAT MM

PERSONALSÄKERHET

RIKTLINJER TAS FRAM AV MR-FYSIKGRUPPEN
TILLSAMMANS MED BFC I SAMRÅD MED SAKKUNNIG
KLINIKER I APPLICERBARA FALL.



VID FRÅGOR KONTAKTA
mrfysik@akademiska.se
Tel: 72 509 (MR-FYSIK PRIMÄRJOUR)



< TILLBAKA

NEURO / OTO

AKTIVA IMPLANTAT

DEEP BRAIN STIMULATOR



TRYCKMÄTARE ICP
(Revidering pågår)



VAGUSNERVSTIMULATOR



INFUSIONSPUMP
BAKLOFEN/SMÄRTA (revidering)



RYGGMÄRGSSTIMULATOR



SHUNTAR



COCHLEAIMPLANTAT
HJÄRNSTAMSIMPLANTAT



SAKRALNERVSTIMULATOR
(Saknas)



PASSIVA IMPLANTAT

ANEURYSM CLIPS



NEUROVASKULÄRA COILS



NEUROVASKULÄRA STENT



STAPESPROTES



ANVISNINGAR

ASM 800 SFINKTER



BENFÖRANKRAT HÖRSEL-
IMPLANTAT



TYMPANOPLASTIK



RICKHAM RESEVOIR




RANEY CLIPS



PULSANTE SPG STIMULATOR



VID FRÅGOR KONTAKTA
mrfysik@akademiska.se
Tel: 72 509 (MR-FYSIK PRIMÄRJOUR)



< TILLBAKA

THORAX

AKTIVA IMPLANTAT

PACEMAKER/ICD/CRT



IMPLANTERBAR
HJÄRTMONITOR



PASSIVA IMPLANTAT

AORTASTENT

$\frac{3.0}{1.5}$ T

CORONARSTENT

$\frac{3.0}{1.5}$ T

HJÄRTKLAFFAR

$\frac{3.0}{1.5}$ T

ANVISNINGAR

THOPAZDRÄNAGE



NAVASOND
EDI-KATETER



VENA CAVA FILTER

$\frac{3.0}{1.5}$ T

TRANSCUTAN PORT

$\frac{3.0}{1.5}$ T

SOFTSPAN EXTERIMITY
EXPANDER




$\frac{3.0}{1.5}$ T

COUPLER RING

$\frac{3.0}{1.5}$ T



VID FRÅGOR KONTAKTA
mrfysik@akademiska.se
Tel: 72 509 (MR-FYSIK PRIMÄRJOUR)



< TILLBAKA

BUK / BÄCKEN

AKTIVA IMPLANTAT

PASSIVA IMPLANTAT

ANVISNINGAR


ENDOSKOPIKA KAPSLAR



MAGNET BLACK STAR STENT



VID FRÅGOR KONTAKTA
mrfysik@akademiska.se
Tel: 72 509 (MR-FYSIK PRIMÄRJOUR)



< TILLBAKA

ORTOPEDI / EXTREMITETER

AKTIVA IMPLANTAT

PASSIVA IMPLANTAT

ANVISNINGAR

EXTERN FIXATION



INTERNA ORTOPEDISKA
IMPLANTAT




EXTREMITETSPROTESER



INTRAOSSEÖS NÅL



VID FRÅGOR KONTAKTA
mr.fysik@akademiska.se
Tel: 72 509 (MR-FYSIK PRIMÄRJOUR)



< TILLBAKA

ÖVRIGT

PASSIVA IMPLANTAT

GRAVID PATIENT



TATUERINGAR
PERMANENT MAKEUP



SPLITTER, KULOR OCH
OKÄNDA METALLFÖREMÅL



ENDOSKOPISKA KAPSLAR



FOLEYKATETER MED
TEMPERATURSENSOR



ANVISNINGAR

MIKRODIALYSPUMP 106/107



CRE BALLON DILATION
CATHETERS



AGRAFFER OCH STAPLES



INTRATEKAL KATETER



LENUS PRO PUMP



COOK-SWARTZ DOPPLER
(INKL INVASIV DOPPLER)



SWAN-GANZ KATETER



ANVISNINGAR

PERIFIX KATETER



3.0
1.5 T

ON-Q PAINBUSTER




OPERATIONSDUK MED
RÖNTGENTRÅD



TANDSTÄLLNING KERAMISK



VID FRÅGOR KONTAKTA
mrfysik@akademiska.se
Tel: 72 509 (MR-FYSIK PRIMÄRJOUR)



[< TILLBAKA](#)

PERSONALSÄKERHET I MR-MILJÖ

RIKTLINJER

GRAVID ARBETSTAGARE



**UTBILDNINGSPPLAN PERSONAL
I MR-MILJÖ**



BEMANNING AV MR-KAMERA



**ALLMÄN OCH SÄRSKILD
BEDÖMNING**



**SYSTEMATISKT
ARBETSMILJÖARBETE**



VID FRÅGOR KONTAKTA
mrfysik@akademiska.se
Tel: 72 509 (MR-FYSIK PRIMÄRJOUR)